Guide utilisateur pompe de nutrition entérale Joey Kangaroo™ (mode nutrition et hydratation)

COVIDIEN

Procédure de chargement de la tubulure

1. Repérer le bouton de démarrage/ arrêt au bas de l'angle droit du panneau de contrôle. Appuyer pour mettre en marche.

2. Confirmer si vous voulez GARDER ou EFFACER les paramètres déjà enregistrés dans la pompe.

3. Avec l'écran de la pompe en face de vous, ouvrir la porte bleue située sur le haut de la pompe.

4. Tenir la valve anti-débit libre par la tablette et insérer la valve sur la tige à gauche.

5. Tenir la bague noire, et étendre doucement le tube de silicone pour l'enrouler autour du rotor dans le sens antihoraire.
Tracter la bague noire pour la placer dans l'emplacement à droite.

6. Fermer la porte bleue. Vous devez lire sur l'écran, tubulure chargée.

Arrêt de la pompe Repérer le bouton de démarrage / arrêt au bas de l'angle droit du panneau de contrôle. Appuyer et tenir le bouton pendant le décompte, jusqu'à ce que l'écran affiche zéro.

Information code erreur

Pompe gardée en attente pendant plus de 10 minutes.

Appuyer sur CONTINUER puis sur LANCER pour démarrer l'administration ou arrêter la pompe.

Problème provenant du rotor et du silicone enroulé sur le rotor.

S'assurer que le silicone est correctement mis en place sur le rotor.

Obstruction sur la ligne aval de la pompe.

Vérifier si la tubulure n'est pas coudée ou bloquée jusqu'au malade et rectifier.

La poche de nutriment est vide ou présence d'une obstruction sur la ligne en amont de la pompe, valve mal positionnée.

Vérifier si la tubulure n'est pas coudée ou bloquée jusqu'à la pompe ou changer la poche de nutriment ou, bien enclencher la valve.

Le conteneur d'eau est vide ou il y a une obstruction sur la ligne en amont de la pompe.

Vérifier si la tubulure n'est pas coudée ou bloquée jusqu'à la pompe ou remplir à nouveau la poche à eau.

La dose de nutrition a été administrée.

Arrêt de la pompe.

La bague noire (MISTIC) n'est pas correctement mise en place dans son logement.

S'assurer que la tubulure est correctement chargée.

La batterie doit être rechargée immédiatement.

Connecter le cordon secteur à la prise secteur.

Erreur générale- voir le manuel pompe.

Envoyer la pompe au SAV.

Purge et programmation de la pompe

1. Appuyer sur AMORCER puis sur Amorçage automatique pour purger automatiquement ou TENIR appuyé le bouton de purge manuelle pour purger la tubulure. Appuyer sur TERMINE quand la tubulure est purgée.

2. Appuyer sur AJUSTER ALIMENTATION puis sur DEBIT pour régler le débit horaire.

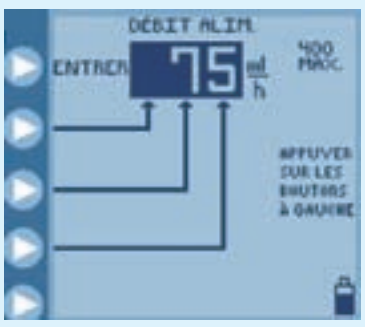

3. Appuyer sur les boutons de gauche pour programmer le débit horaire (unités, dizaines, centaines). Appuyer sur ENTRER pour confirmer.

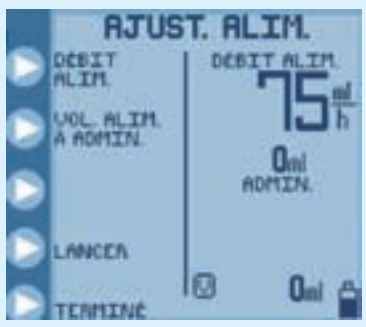

4. Appuyer sur VOLUME à administrer pour programmer la dose à délivrer si besoin.

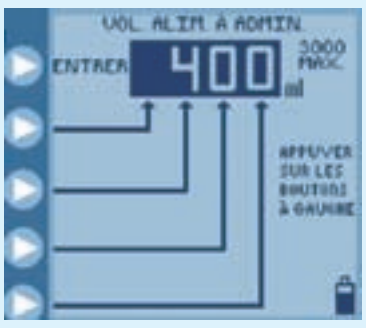

5. Appuyer sur les boutons de gauche pour programmer la dose d'alimentation à délivrer (unités, dizaines, centaines, milliers). Appuyer sur ENTRER pour confirmer, puis sur TERMINER pour revenir à l'écran principal.

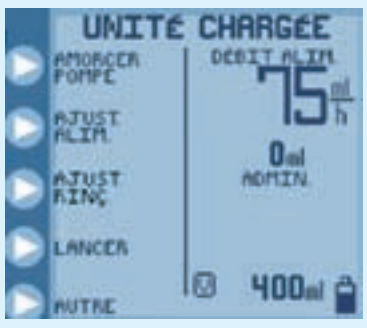

6. Appuyer sur AJUSTER RINCAGE pour programmer le volume et l'intervalle de rinçage/hydratation.

7. Appuyer sur VOLUME de RINCAGE pour programmer le volume de rinçage/ hydratation. Appuyer sur INTERVALLE de RINCAGE pour programmer l'intervalle entre chaque rinçage/hydratation.

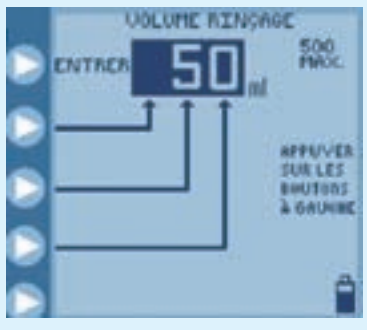

8. Appuyer sur les boutons de gauche pour programmer le volume de rinçage/hydratation à administrer (unités, dizaines, centaines). Puis appuyer sur ENTRER pour confirmer.

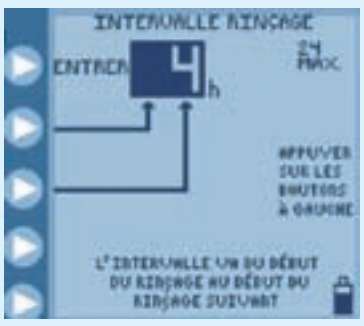
INTERVALLE RINÇAGE
ENTRER
4 h
24 MAX.
APPUYER SUR LES BOUTONS À GAUCHE
L'INTERVALLE VA DU DÉBUT DU RINÇAGE AU DÉBUT DU RINÇAGE SUIVANT

9. Appuyer sur les boutons de gauche pour programmer l'intervalle entre chaque rinçage/ hydratation. Appuyer sur TERMINE pour revenir à l'écran principal.

10. Appuyer sur LANCER pour commencer le cycle de nutrition. Pour administrer avec la plus grande précision, le niveau haut du nutriment dans la poche en début de cycle doit se situer à une hauteur de 15cm au dessus du haut de la pompe.

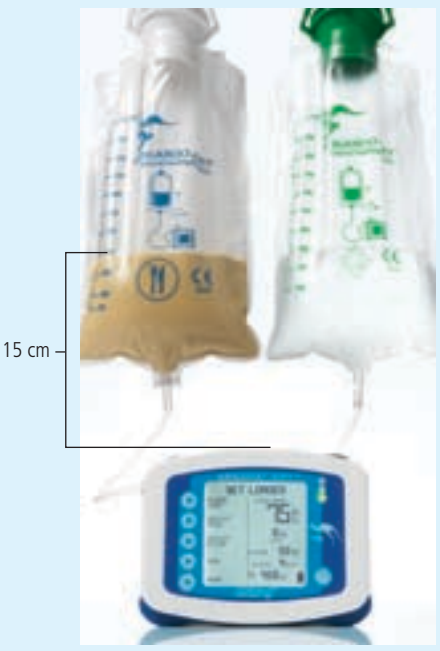

Pour plus d'information merci de consulter le manuel d'utilisation et de maintenance de la pompe de nutrition entérale ePump Kangaroo™

Covidien France SAS, 2, rue Denis Diderot, 78990 elancourt, france. [t] + 33 (0)1 30 79 80 00

www.covidien.com

COVIDIEN, COVIDIEN et son logo et Covidien logo sont des marques US et des marques de Covidien AG enregistrées internationnalement. Les autres marques sont des marques d'une société Covidien. © 2011 Covidien.

MS/2011/SV/0243/FR